



-Western

电源适配器 + 电源线

4、红色光圈:

注意: 遥控器内置可充电锂电池, 充电时间约2小时。

光圈熄灭。

a、充电时光圈淡入淡出;充电完成后,

中文

b、使用过程中,光圈处于闪烁状态。

USB-Micro USB连接线

主副箱连接线

音频转接线

不到的地方。 · 请勿擅自打开或移开外壳进行维修,那有可能会使您触及危险电压或导致其它危险。无论本产品因何原因损坏,都必须请专业维 修人员修理(如电源线或插头损坏,液体溅入或物体落入,淋过 雨或受过潮、不能正常工作或被摔过)。 · 在用干布擦拭、清洁产品之前,请先将本产品关机,并拔下供电 的插头。 · 请勿使用强酸、强碱、汽油、酒精等化学溶剂擦拭产品表面,如 需清洁,请使用中性溶剂或清水。

使用时,如果音量过高,可能会造成听力损伤,请将音量调到安全水平。

正确处置废弃电子产品。不可将电子电气设备、部件、电池与其它生活垃圾一起丢弃。为防止这些物品可能含有的有害物质污染自然补燥和对人体造成伤害,和保证资源的循环利用,请采用废品回收或当地的处理相关法律和规定回收本产品,或联系本产品的零售商。

Ā

3 中文

便的使用。

7、连接副箱

9、线槽

10、连接主箱

8、软件更新接口

警告!

电池更换不当会有爆炸危险,只能用同样类型或等效类型的电池来更换。


针对可折卸电池的产品,电池务必回收或妥善处理,针对不可拆卸电池的产品,禁止拆解。


电池禁止拆解,建击,挤压或投入火中。请勿使电池暴露在导电材料,液体、火或高温中、不要让金属物体接触电池的两极。

如果电池出现歧胀,泄漏,变色,异味或出现其它任何异常,请勿继续使用,电池浸水后禁止使用。

无线产品发出的短波无线电频率信号可能会影响其它电子设备和 医疗设备的正常使用。在禁止使用的地方请关掉本产品。
 在医疗机构内、飞机上、加油站、自动门、火警自动警报设备或 其它自控设备附近、请勿使用本产品。
 在距离电子起搏器或其它医疗设备20cm的范围以内、请勿使用本 产品,无线电波可能会影响电子起搏器或其它医疗设备的正常使用。



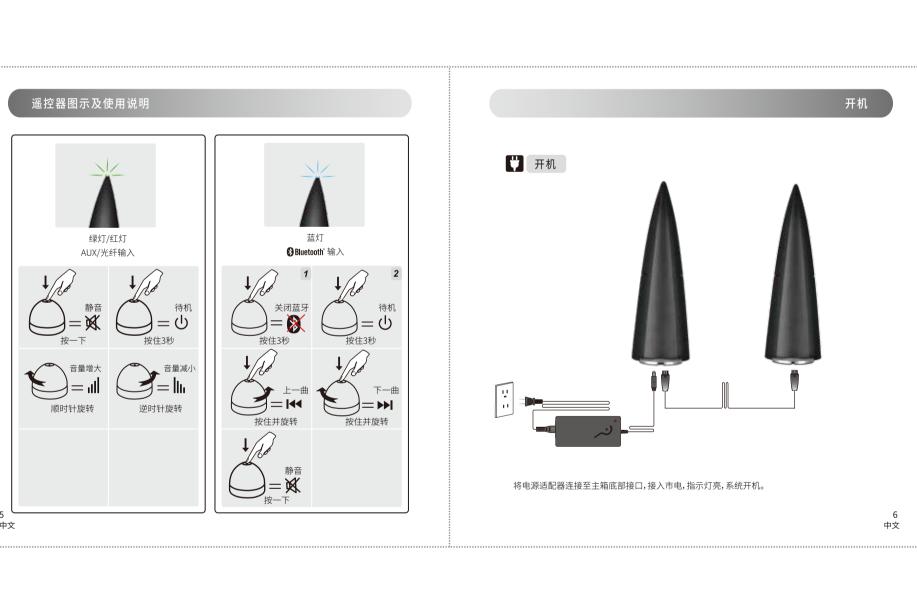

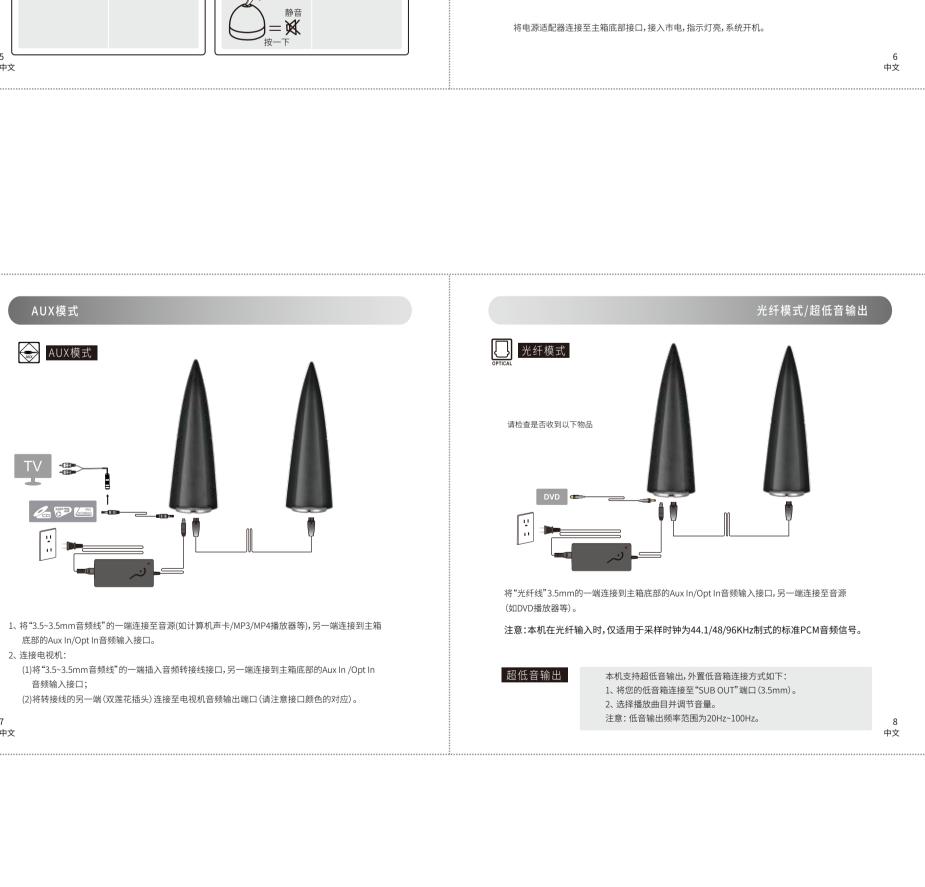



					产品中有	有害物质的 ?	名称及含量
音箱无声,怎么办?◆请断开音箱电源后重新开机	产品中有害物质的名称及含量						
请检查电源插头是否插好,插座是否通电。	部件名称	有害物质 组(Pb) 素(Hg) 镍(Cd) 六价铬 多溴联苯 多溴二苯					
● 请检查音源和连接线是否正常。		铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	(Cr(VI))	(PBB)	PBDE
● 请检查音箱是否处于待机状态。	金属部件	×	0	0	0	0	0
请检查音源信号输出是否正常。	木制部件	0	0	0	0	0	0
● 请检查音箱或音源的音量是否已被调至最小。	塑料部件	0	0	0	0	0	0
	电线电缆	0	0	0	0	0	0
全 如果您还有其他疑问	电路板组值	ŧ 0	0	0	0	0	0
请拨打本公司技术服务电话(详见售后服务卡)。	电镀件	0	0	0	0	0	0
	○:表示该有 ×:表示该有 在某些产品 电池生产商	害物质至少在 中可能包含电	3件所有均质。 该部件的某一 池,该电池并	一均质材料中 非漫步者产品	中的含量超出G 品,该电池的关	2规定的限量要 B/T 26572规定 于有害物质含量	的限量要求。

中文