


HECATE

G30^S DUAL-MODE WIRELESS GAMING HEADSET 双模无线游戏耳麦 说明书

■ 产品说明及配件

- ① 模式切换键
- ② 状态指示灯
- ③ 多功能“G”键
- ④ 麦克风指示灯
- ⑤ 麦克风开/关键
- ⑥ 音量调节旋钮
- ⑦ 充电接口
- ⑧ 麦克风
- ⑨ 2.4G接收器

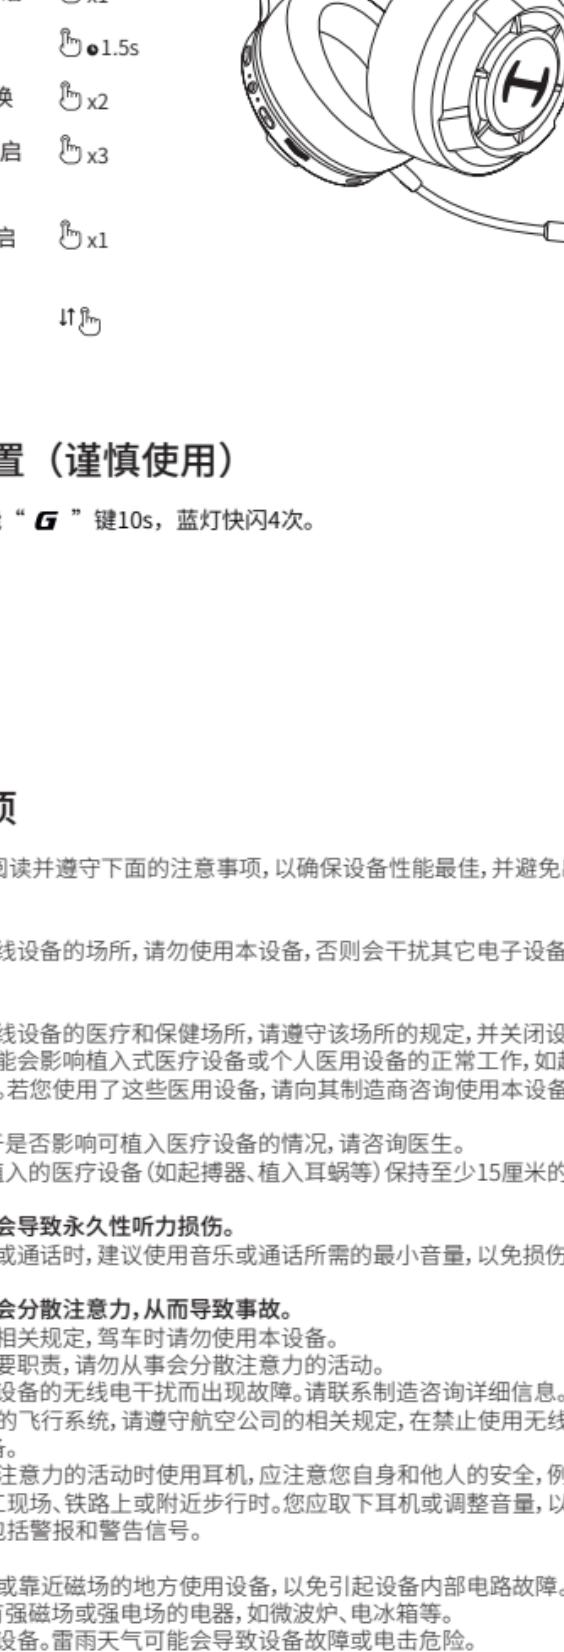

■ 保修卡

感谢您选购漫步者耳机，为维护您的权益，本公司提供如下的售后服务：

● 咨询服务：

用户在使用过程中遇到任何问题，均可致电：4006003968咨询或登录：www.edifier.com查询。

● 保修服务：

我司保修服务不包括送修产品的运费及上门服务。用户可到当地售后服务中心享受我公司提供的自购买之日起一月包换（注：在外观无损，配件齐全前提下），一年保修的服务；若当地没有相应的售后服务中心，请致电：4006003968，在得到厂家客服确认并受理后，请将售后品寄往厂家售后部门。

注：请务必先致电客服确认受理。

● 若有以下原因造成的耳机损坏，恕不提供保修服务：

1.非正常使用：使耳机头带、麦克风柄线折断，信号线断裂，耳壳破裂。

2.不当存储：如耳机长时间暴露在潮湿环境中使扬声器、麦克风浸水。

3.未经本公司授权的维修。

● 使用本产品前，请仔细阅读本产品的使用说明。

● 本公司保留对该产品售后服务条例的最终解释权。

● 售后收件电话：0769-88986868

● 售后收件地址：东莞市松山湖工业东路2号漫步者工程部返修组

■ 安全注意事项

在使用和操作设备前，请阅读并遵守下面的注意事项，以确保设备性能最佳，并避免出现危险或非法情况。

● 电子设备

● 有明文规定禁止使用无线设备的场所，请勿使用本设备，否则会干扰其它电子设备或导致其它危险。

● 对医疗设备的影响

● 在明文规定禁止使用无线设备的医疗和保健场所，请遵守该场所的规定，并关闭设备。

● 设备产生的无线电波可能会影响植入式医疗设备或个人医用设备的正常工作，如起搏器、植入耳蜗、助听器等。若您使用了这些医用设备，请向其制造商咨询使用本设备的限制条件。

● 设备含有磁性材料，关于是否影响可植入医疗设备的情况，请咨询医生。

● 在使用本设备时，请与植入的医疗设备（如起搏器、植入耳蜗等）保持至少15厘米的距离。

● 当您使用耳机收听音乐或通话时，建议使用音乐或通话所需的最小音量，以免损伤听力。

● 交通安全

● 驾车时接触高音量可能会分散注意力，从而导致事故。

● 遵守所在地区或国家的相关规定，驾车时请勿使用本设备。

● 谨记安全驾驶是您的首要职责，请勿从事会分散注意力的活动。

● 汽车的电子设备可能因设备的无线电干扰而出现故障。请联系制造咨询详细信息。

● 无线设备可能干扰飞机的飞行系统，请遵守航空公司的相关规定，在禁止使用无线设备的地方，请勿使用该设备。

● 如果您在从事需要集中注意力的活动时使用耳机，应注意您自身和他人的安全，例如骑自行车或在道路、施工现场、铁路上或附近步行时。您应取下耳机或调整音量，以确保可以听到周围的声音，包括警报和警告信号。

● 请勿拆卸或改装电池、插入异物、或浸入水或其他液体中，以免引起电池漏液、过热、起火或爆炸。电池只能由制造商更换。

● 请勿跌落、挤压或穿刺电池。避免让电池遭受外部大的压力，从而导致电池内部短路和过热。

● 请勿将大头针等尖锐金属物品放置在设备听筒或者扬声器附近，以免金属物品附着，对您造成伤害。

● 请勿将电池放入火中或置于高温中，置于火中或温度超过100°C的环境中会导致爆炸。

● 请勿将电池产品放置在靠近磁场的地方，以免引起设备内部电路故障。

● 请勿将电池产品放置在靠近强磁场或强电场的电器，如微波炉、冰箱等。

● 请勿将电池产品放置在靠近强磁场或强电场的电器，如微波炉、冰箱等。</p